


大型仪器（机时）预约操作说明

目录

大型仪器（机时）预约操作说明	1
一．大型仪器系统-仪器管理与开放：	3
二．实验室及仪器设备开放共享平台-机时预约：	4
三．手机端-机时预约：	13


1、入网状态

仪器入网状态可以调整【仪器信息管理】【仪器开放调整】模块的入网监控可以根据仪器修改状态。如果修改后，仪器依旧显示为未入网状态，需联系门禁与仪器硬件维护相关人员，查看仪器状态。

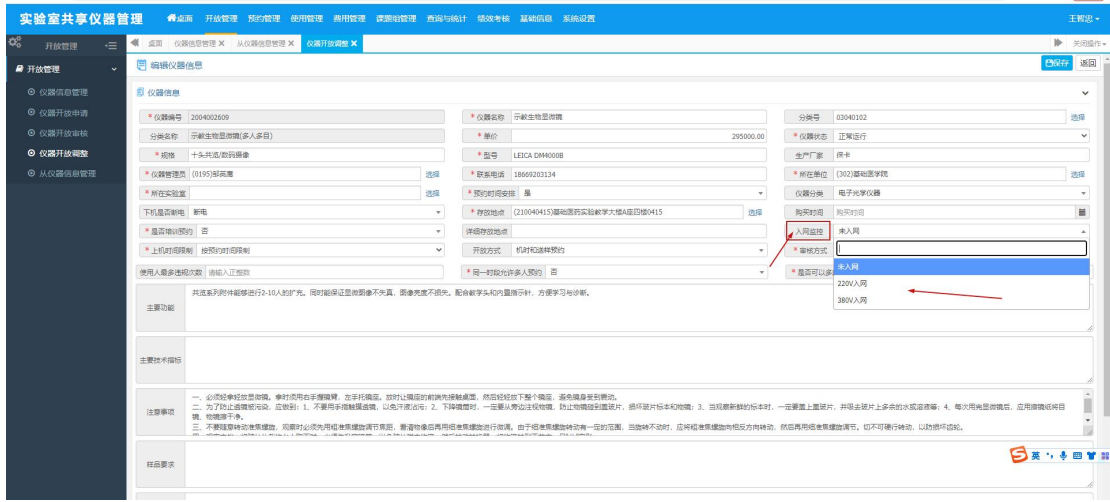

2. 仪器刷卡下机断电

在【仪器信息管理】【仪器开放调整】模块的下机是否断电和上机时间限制，【下机是否断电】可以调整，用户刷卡下机后，断不断电。【上机时间限制】可以调整仪器当天一次预约后，当天任意时段不用再次重复预约。

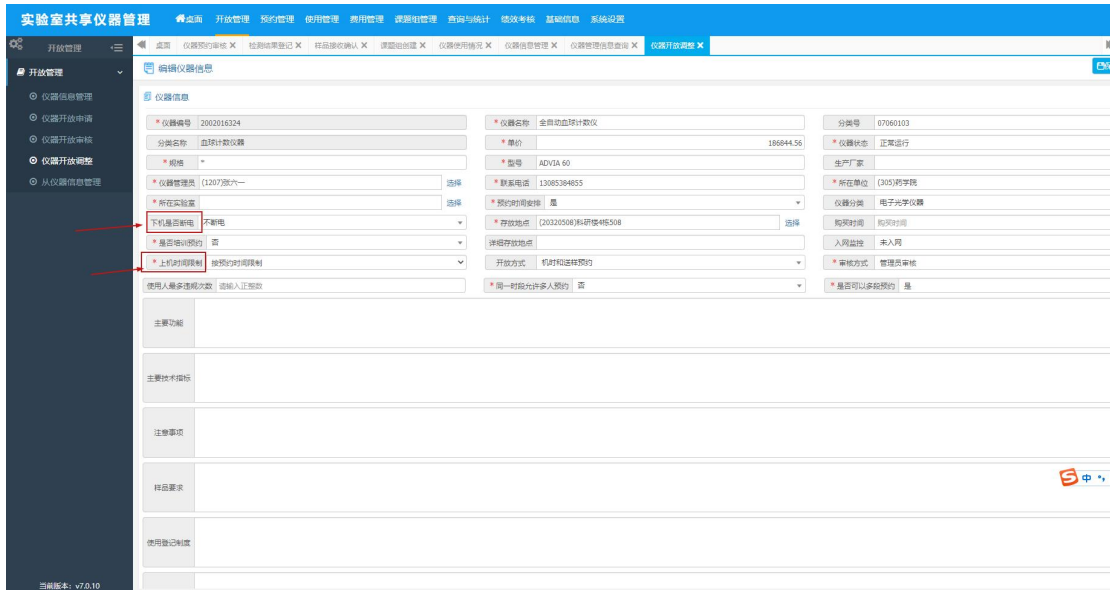


3. 人员上机无需预约

除设备管理员外无需预约即可刷卡上机外，设备管理员在【仪器开放调整】模块，点击授权设备使用人，可以制定其他人员为设备使用人，指定的人员同样可以直接刷卡上下机，无需预约。

序号	发布日期	仪器编号	仪器名称	仪器管理	单价	规格	型号	所在单位	存放地点	状态	操作
1	已发布	2002008817	全自动生化分析仪 (1207)六一	522218.97	生化全套、葡萄糖测定、血糖全套	TMS-1024	(K0Y00000-1)清华大学物理学院物理系实验室	(20220508)科研楼405508	正常运行	编辑发布 编辑 删除	
2	已发布	2002016324	全自动血球计数仪 (1207)六一	188644.56	*	ADVIA 60	(305)药学院	(20220508)科研楼405508	正常运行	编辑发布 编辑 删除	
3	已发布	2003016343	电液组织培养仪 (1197)王鹏	426000.00	水平光学传感/3.2L	LEICA APS 200	(305)药学院	(20220508)科研楼405508 (附体)	正常运行	编辑发布 编辑 删除	
4	已发布	2004002609	核酸生物显微仪 (0195)李英海	295000.00	十头共混/数控摄像	LEICA DM4000B	(302)基础医学院	(210040415)基础医学院实验楼大堂A座三层0415	正常运行	编辑发布 编辑 删除	
5	已发布	2004002640	激光荧光显微成像系统 (1218)王廷华	345000.00	*	NIRX SPOT RT	(302)基础医学院	(20230510)实验动物楼2F-一层	维修	编辑发布 编辑 删除	
6	已发布	2004002655	荧光显微仪 (0271)王江	218645.00	*	Nikon B 600	(302)基础医学院	(210030302)基础医学院实验楼大堂A座三层0302	正常运行	编辑发布 编辑 删除	
7	已发布	2004007005	生物洁净工作台	100000.00	不锈钢/带紫外线	A2	(406)生物医学工程学院中心	(000000001)基础医学院	正常运行	编辑发布 编辑 删除	
8	已发布	2005000748	原子荧光光谱仪 (1653)张健	164700.00	双道	AFS-3100	(303)公共卫生学院	(20040106)达理楼106 (国家仪器2)	正常运行	编辑发布 编辑 删除	
9	已发布	2005000775	透射电镜 (0453)张健	250000.00	0.001-20mm/min/0-50mpa	P 600A	(305)药学院	(20060303)药学院303 (1)	正常运行	编辑发布 编辑 删除	
10	已发布	2005000776	高压电镜 (1877)孙永	305000.00	精度MSD 0.2%	LC-2010A HT	(305)药学院	(20220211)科研楼405511 (实验楼)	正常运行	编辑发布 编辑 删除	
11	已发布	2005000830	发菌罐 (1411)徐天	520200.00	*	BioRa-410	(407)科技成果转化中心 (技术转移中心)台香	(20220508)科研楼405509 (实验楼)	正常运行	编辑发布 编辑 删除	
12	已发布	2005002973	原子吸收分光光度计 (1267)杨华	175000.00	火焰型	Z-2300	(303)公共卫生学院	(20040106)达理楼106 (国家仪器2)	正常运行	编辑发布 编辑 删除	
13	已发布	2005002974	原子吸收分光光度计 (0126)杨华	405000.00	石墨炉型	Z-2700	(303)公共卫生学院	(20040106)达理楼106 (国家仪器2)	正常运行	编辑发布 编辑 删除	
14	已发布	2005002994	透射电镜 (1195)张健	1995365.00	600000x2.0A/4.5	JEM-1011	(407)科技成果转化中心 (技术转移中心)台香	(20210105)达理楼105 (国家仪器)	正常运行	编辑发布 编辑 删除	
15	已发布	2005002995	扫描电镜 (1510)张健	927265.00	分辨率4nm/放大30万x	S-3000M	(407)科技成果转化中心 (技术转移中心)台香	(20210105)达理楼101 (国家仪器)	正常运行	编辑发布 编辑 删除	
16	已发布	2006000777	气相色谱仪 (1962)张健	348000.00	FID/ECD/PFP检测器	CP-3800	(303)公共卫生学院	(20040106)达理楼105 (国家仪器)	正常运行	编辑发布 编辑 删除	
17	已发布	2006002983	核酸蛋白检测仪 (1461)张健	104500.00	220-750nm/紫外/可见光/测速	ND-1000	(407)科技成果转化中心 (技术转移中心)台香	(20220508)科研楼405508 (附体)	正常运行	编辑发布 编辑 删除	
18	已发布	2006002984	微量分光光度计 (1454)张健	188000.00	V型光束/分光光度计	DMRB	(303)公共卫生学院	(20040106)达理楼105 (国家仪器)	正常运行	编辑发布 编辑 删除	
19	已发布	2006003232	凝胶成像仪 (1840)张健	171387.00	一流ig, 17寸	T461	(407)科技成果转化中心 (技术转移中心)台香	(20220515)科研楼405511 (实验楼)	正常运行	编辑发布 编辑 删除	
20	已发布	2006004954	生物数字显微分析仪 (1822)王鹏	139000.00	8通道	ML 785	(302)基础医学院	(210080819)基础医学院实验楼大堂A座三层0819	正常运行	编辑发布 编辑 删除	

4. 仪器发布与预约操作流程:

预约流程图:

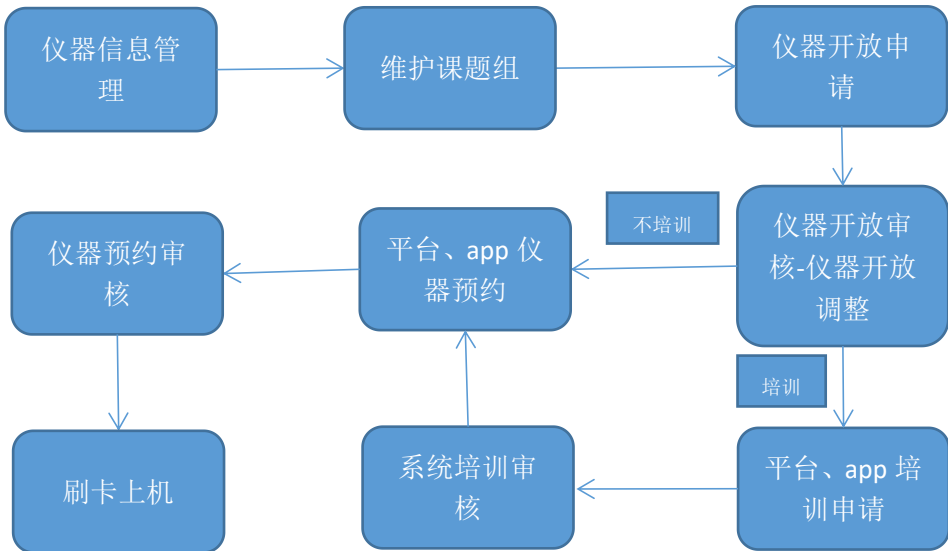

一. 大型仪器系统-仪器管理与开放:


1.在仪器预约前,需要仪器管理员老师,将仪器维护好,登录系统,【开放管理】-【仪器信息管理】模块进行仪器维护。

其中下机是否断电,选择【断电】则刷卡下机自动断电,选择【不断电】则不会自动断电。

是否预约培训,选择【是】,则需要预约人先通过仪器使用培训,管理员通过后,方可上机。选择【否】则预约人可以直接预约,预约通过后即可上机,不需要培训。

是否可以多段预约,选择【是】,预约人可以选择多个日期时段进行预约,选择【否】,预约人只能选择一个日期一个时段预约。

入网监控，根据仪器状态，选择【220V入网】、【380V入网】和【未入网】，【仪器实时状态查询】查询220V入网信息，【380V实时状态查询】查询380V入网信息。

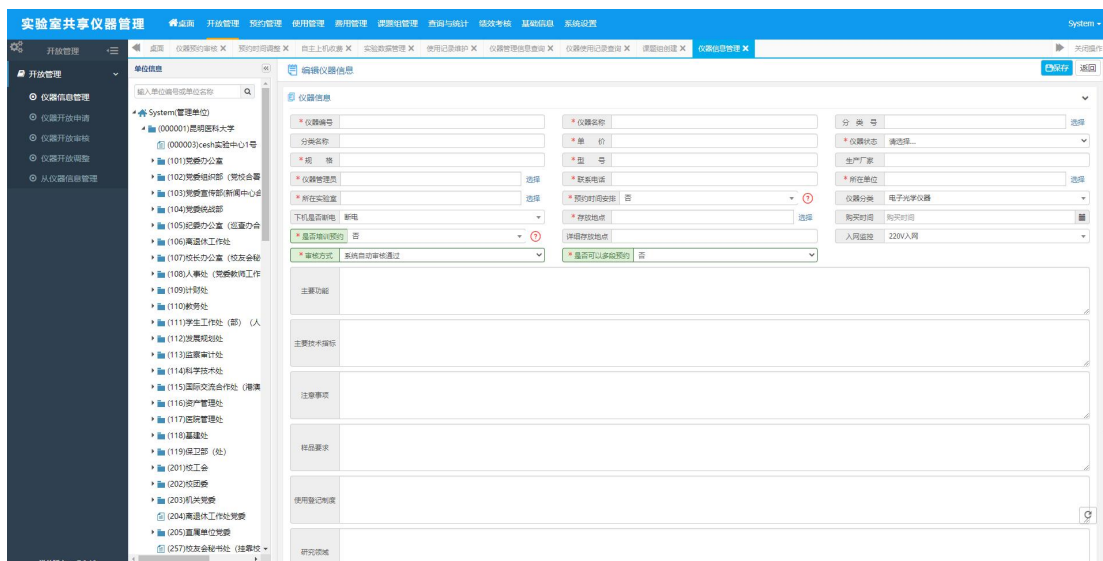


仪器维护完成，在【仪器开放申请】提交，由学院管理员在【仪器开放审核】通过，进入【仪器开放调整】模块，点击发布，仪器即发布到学校实验室及仪器设备开放共享平台，申请人可以由平台或者手机端进行预约了。

【仪器开放调整】模块，可以将已经发布到平台的仪器撤回。也可以调整已经发布的仪器各种预约类型，比如是否预约培训，下机是否断电等，都可以再次进行调整。【仪器开放调整】可以增加设备授权使用人，授权的人员可以与管理员一样直接刷卡上下机，无需预约。


二. 实验室及仪器设备开放共享平台-机时预约：

预约前的第一步：加入课题组


校内老师、学生：联系负责老师在【课题组创建】模块增加课题组并提交至二级学院管理员进行审核。（如果负责老师已有课题组，则直接在【课题组成员管理】模块维护课题组成员即可）。

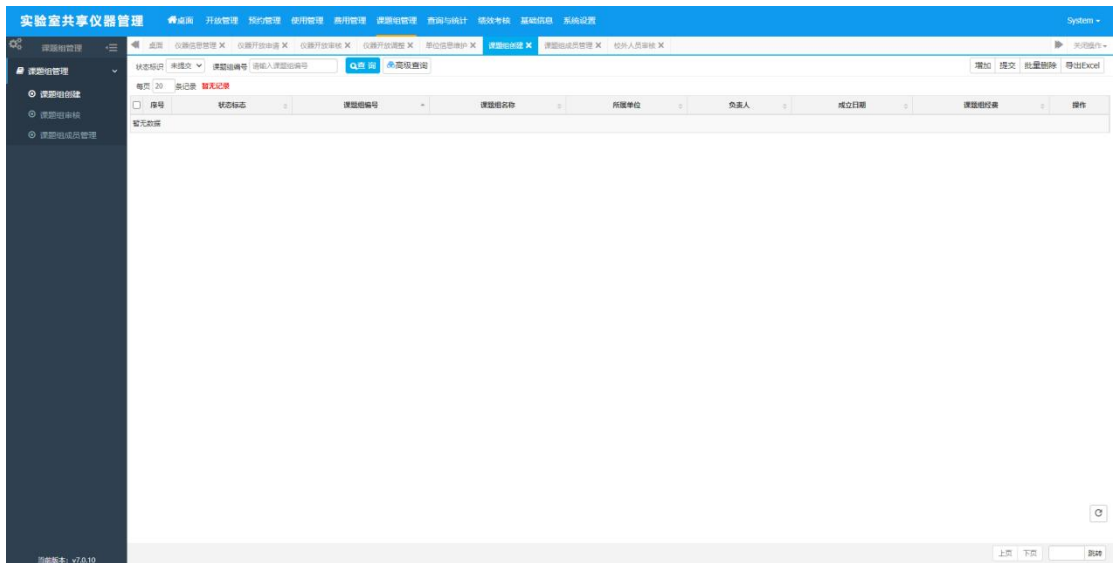


二级学院管理员在【课题组审核】模块进行课题组的审核。

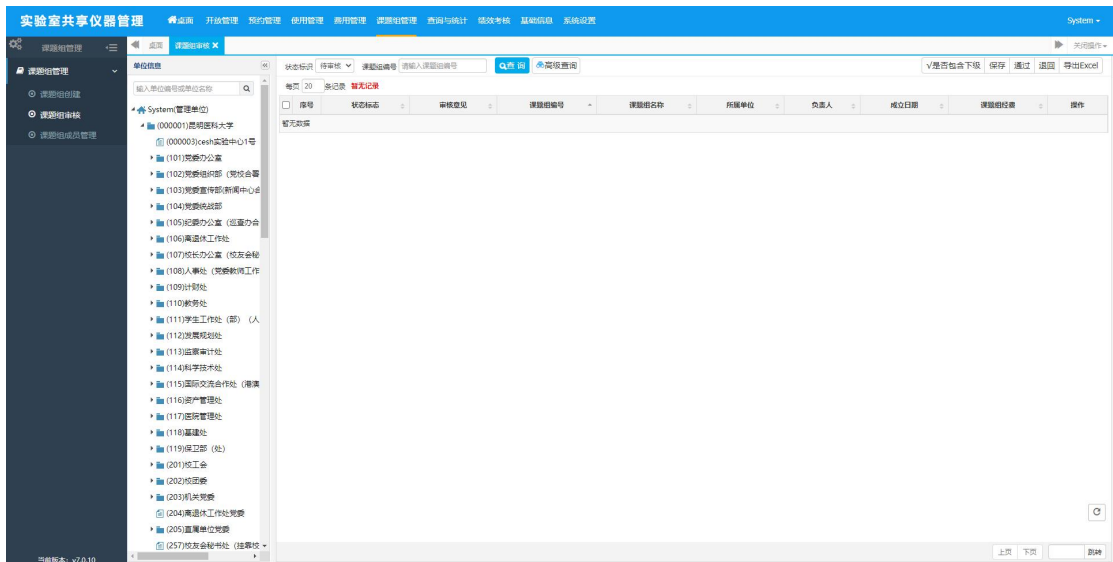

审核通过后，由负责老师在【课题组成员管理】模块，维护课题组的成员。

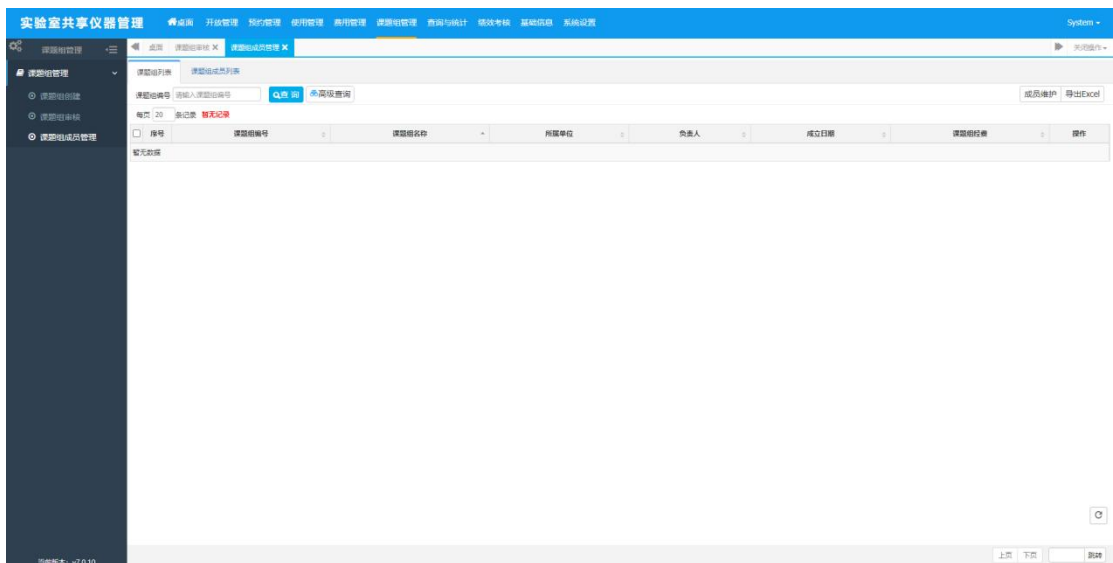

校外人员：校外人员首次使用平台，需要进行注册。管理员在【校外人员审核】的时候，为其分配课题组。

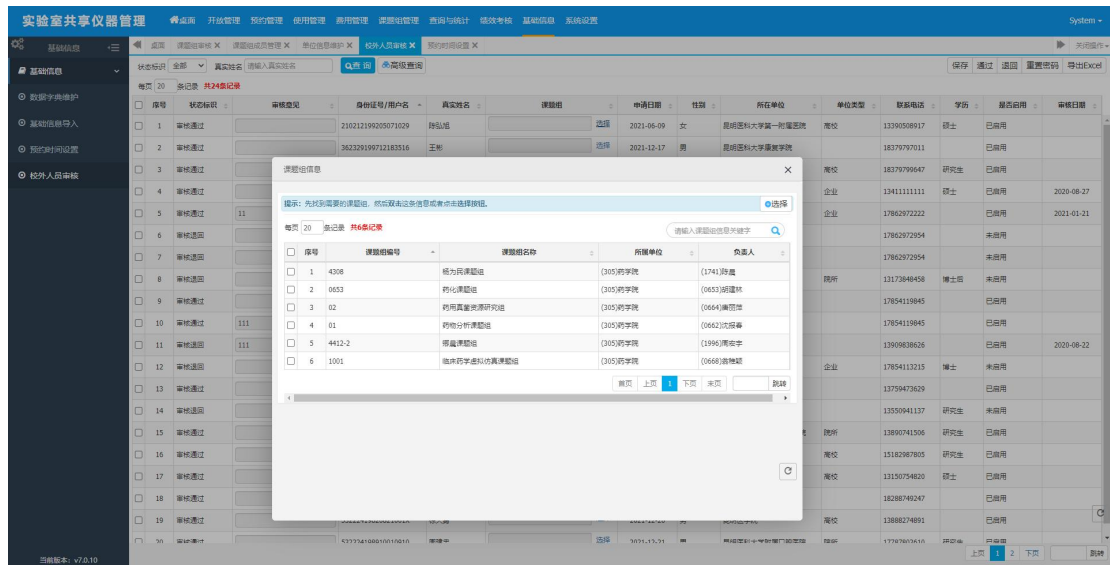

1. 登录大型仪器预约设备共享平台：使用学生（学号）、教师（工号）、校外人员（先注册，由管理员在【校外人员审核】进行审核），密码登录平台。



2. 在【仪器展示】模块，点击“预约”按钮进行，选择机时预约，选择可选时段，点击下一步，填写相关预约单信息并提交，等待**仪器管理员**审核及安排实验时间。

昆明医科大学 | 实验室及仪器设备开放共享管理平台

首页 仪器展示 新闻动态 规章制度 通知公告 办事指南

高级护理及助产模拟培训系统

【仪器编号】: 2019519402 【规格型号】: S2200 S2200
【所属学院】: 护理学院 【所属实验室】: 无
【仪器状态】: 正常运行 【开放范围】: 机时和选择预约

高级液相色谱仪

【仪器编号】: 2017011900 【规格型号】: 赛默飞 并联双柱系统, 速度...
【所属学院】: 药学院 【所属实验室】: 无
【仪器状态】: 正常运行 【开放范围】: 机时和选择预约

智能无线医学模拟系统

【仪器编号】: 2017008400 【规格型号】: 可实现在线交流 (配有无线通...
【所属学院】: 药学院 【所属实验室】: 无
【仪器状态】: 正常运行 【开放范围】: 机时和选择预约

多功能酶标仪

所属学院: 护理学院 所属实验室: S2200/S2200
仪器管理员: 张争鸣 规格型号: S2200/S2200
联系电话: 生产厂家:

0人收藏 0人使用 0次预约 0小时总时长

照片还未上传

仪器信息 机时预约 预约评价

可预约 未开放/已过期 他人已约 我已约

当前日期: 2022-03-31

时间段	周日 (2022-03-27)	周一 (2022-03-28)	周二 (2022-03-29)	周三 (2022-03-30)	周四 (2022-03-31)	周五 (2022-04-01)	周六 (2022-04-02)
00:00-00:20							
00:20-00:40							
00:40-01:00						已选择	
01:00-01:20							
01:20-01:40							
01:40-02:00							
02:00-02:20							
02:20-02:40							
02:40-03:00							
03:00-03:20							
已选时间段	周五(2022-04-01) 00:40-01:00;						

下一步

照片还未上传

所属学院: 护理学院 所属实验室: S2200/S2200
仪器管理员: 张争鸣 规格型号: S2200/S2200
联系电话: 生产厂家:

0人收藏 0人使用 0次预约 0小时总时长

照片还未上传

仪器信息 机时预约 预约评价

可预约 未开放/已过期 他人已约 我已约

当前日期: 2022-03-31

时间段	周日 (2022-03-27)	周一 (2022-03-28)	周二 (2022-03-29)	周三 (2022-03-30)	周四 (2022-03-31)	周五 (2022-04-01)	周六 (2022-04-02)
00:00-00:20							
00:20-00:40							
00:40-01:00						已选择	
01:00-01:20							
01:20-01:40							
01:40-02:00							
02:00-02:20							
02:20-02:40							
02:40-03:00							
03:00-03:20							
已选时间段	周五(2022-04-01) 00:40-01:00;						

下一步

机时预约申请表

预约时段: 周五(2022-04-01) 00:40-01:00

共计: 0.33 小时

*申请人: @00000System

*手机号:

*导师: 请选择...

*样品信息:


*样品数量:

备注:


提交


3. 如果此仪器需要进行培训后方可使用, 则点击“培训通知”按钮, 点击报名按钮,

填写并提交申请报名信息。

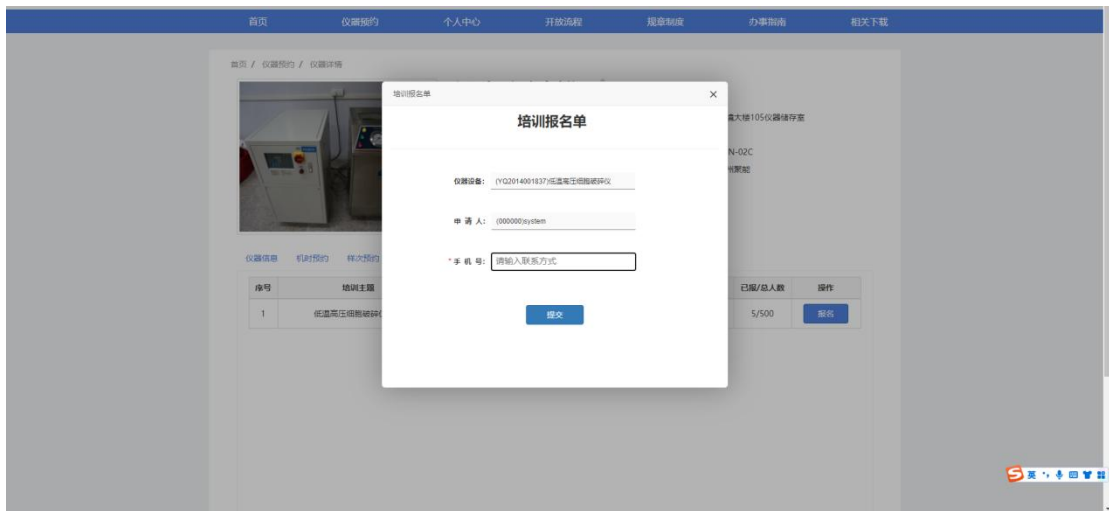


4. 由仪器设备管理员在系统后台的【培训申请审核】模块，对提交的培训申请进行审核。对审核通过的培训申请进行培训结果登记，并复核，复核通过则培训完成。

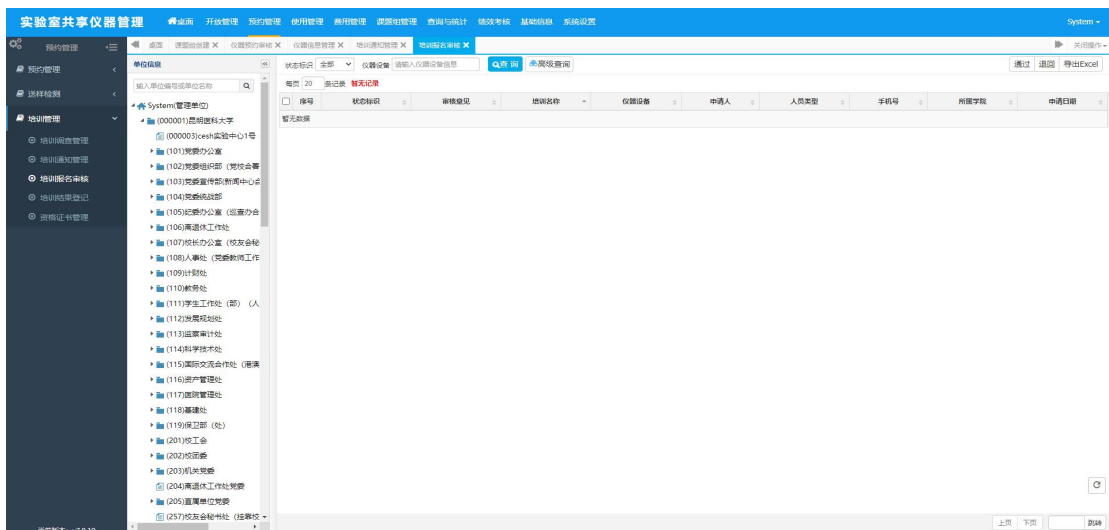

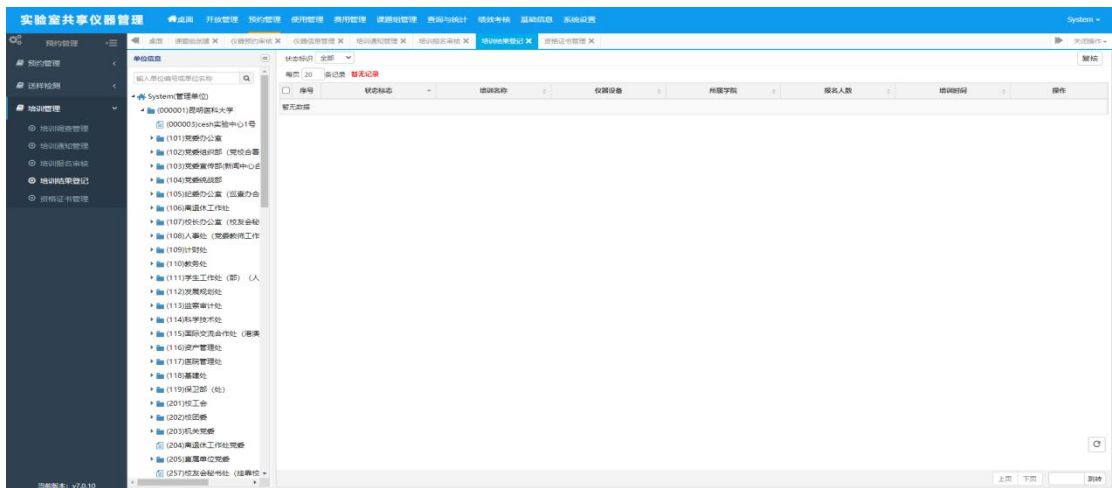

5. 待培训通过后，如文档第二项，选择预约时间段，点击“提交”按钮提交预约申请。

等待**仪器管理员**审核及安排实验时间。

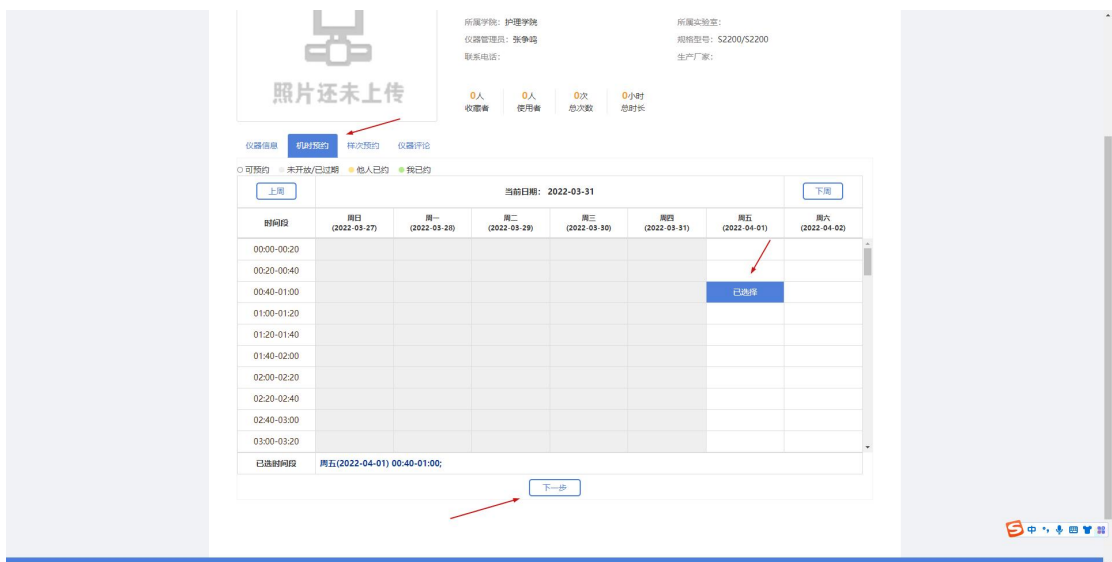

6. 由仪器管理员登录后台，在【仪器管理】-【仪器预约审核】模块对已提交的预约单进行审核。

序号	状态	审核信息	预约时间	预约日期	仪器编号	仪器名称	型号	仪器管理师	存放地点	申请人编号	申请人姓名	申请人身份	联系电话	操作
1	待审核			2022-03-10, 2022-03-11	2009002375	电镜	TM-1000	[1410]李博	(20300106)科研楼2楼106 (仪器室)	20200105	李博	校内学生	18468289588	审核 查看
2	待审核			2022-03-07	2015140200	正置共焦扫描电镜系统BX53F	BX53F	[1684]杨李芳	(20300106)科研楼2楼106 (仪器室)	20211712	沈金玉	校内学生	18087468499	审核 查看
3	待审核			2022-03-07	2009002375	电镜	TM-1000	[1410]李博	(20300106)科研楼2楼106 (仪器室)	20200401	刘通	校内学生	15672620030	审核 查看
4	待审核			2022-03-09, 2022-03-10	2013061600	超高速流式细胞分析分选工作站	CyFlow Space	[1682]郑奕奕	(20300109)科研楼2楼109 (仪器室 (重点))	1682	郑奕奕	校内教师	15288442110	审核 查看
5	待审核			2022-03-07	2013061600	超高速流式细胞分析分选工作站	CyFlow Space	[1682]郑奕奕	(20300109)科研楼2楼109 (仪器室 (重点))	1462	张桂莹	校内教师	1357702672	审核 查看
6	待审核			2022-03-06	2013061600	超高速流式细胞分析分选工作站	CyFlow Space	[1682]郑奕奕	(20300109)科研楼2楼109 (仪器室 (重点))	1462	张桂莹	校内教师	1357702672	审核 查看
7	待审核			2022-03-07	2015140200	正置共焦扫描电镜系统BX53F	BX53F	[1684]杨李芳	(20300106)科研楼2楼106 (仪器室)	20180012	王小倩	校内学生	18388171992	审核 查看
8	待审核			2022-03-08	2015140200	正置共焦扫描电镜系统BX53F	BX53F	[1684]杨李芳	(20300106)科研楼2楼106 (仪器室)	20180012	王小倩	校内学生	18388171992	审核 查看
9	待审核			2022-03-11	2015140200	正置共焦扫描电镜系统BX53F	BX53F	[1684]杨李芳	(20300106)科研楼2楼106 (仪器室)	20180012	王小倩	校内学生	18388171992	审核 查看
10	待审核			2022-03-09	2015140200	正置共焦扫描电镜系统BX53F	BX53F	[1684]杨李芳	(20300106)科研楼2楼106 (仪器室)	20190044	黄文文	校内学生	13678753682	审核 查看
11	待审核			2022-03-13	2015140200	正置共焦扫描电镜系统BX53F	BX53F	[1684]杨李芳	(20300106)科研楼2楼106 (仪器室)	20180012	王小倩	校内学生	18388171992	审核 查看
12	待审核			2022-03-31	2015140600	植物精油提取仪	NEOS	[0126]滕叶梅	(20040211)达观楼111 (样品处理室)				1872125983	审核 查看
13	待审核			2022-03-31	2015141000	超净工作台	HE-VAP Advantage ML	[1777]戴海梅	(20040116)达观楼116 (学生实验室)	201928040	姜妍燕	校内学生	18988225807	审核 查看

7. 仪器管理员审核时，如果申请人未选择预约时间，审核人可以点击空闲时间，为申请人安排预约时间，如申请人已经选择预约时间，则无需再次安排。

时间	仪器1	仪器2	仪器3	仪器4	仪器5	仪器6	仪器7	仪器8	仪器9	仪器10	仪器11	仪器12	仪器13	仪器14	仪器15	仪器16	仪器17	仪器18	仪器19	仪器20
16:20-16:40	预约不可用	预约不可用	预约不可用	预约不可用	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲
16:40-17:00	预约不可用	预约不可用	预约不可用	预约不可用	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲
17:00-17:20	预约不可用	预约不可用	预约不可用	预约不可用	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲
17:20-17:40	预约不可用	预约不可用	预约不可用	预约不可用	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲
17:40-18:00	预约不可用	预约不可用	预约不可用	预约不可用	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲
18:00-18:20	预约不可用	预约不可用	预约不可用	预约不可用	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲
18:20-18:40	预约不可用	预约不可用	预约不可用	预约不可用	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲
18:40-19:00	预约不可用	预约不可用	预约不可用	预约不可用	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲
19:00-19:20	预约不可用	预约不可用	预约不可用	预约不可用	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲
19:20-19:40	预约不可用	预约不可用	预约不可用	预约不可用	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲
19:40-20:00	预约不可用	预约不可用	预约不可用	预约不可用	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲
20:00-20:20	预约不可用	预约不可用	预约不可用	预约不可用	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲
20:20-20:40	预约不可用	预约不可用	预约不可用	预约不可用	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲
20:40-21:00	预约不可用	预约不可用	预约不可用	预约不可用	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲
21:00-21:20	预约不可用	预约不可用	预约不可用	预约不可用	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲
21:20-21:40	预约不可用	预约不可用	预约不可用	预约不可用	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲
21:40-22:00	预约不可用	预约不可用	预约不可用	预约不可用	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲
22:00-22:20	预约不可用	预约不可用	预约不可用	预约不可用	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲
22:20-22:40	预约不可用	预约不可用	预约不可用	预约不可用	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲
22:40-23:00	预约不可用	预约不可用	预约不可用	预约不可用	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲
23:00-23:20	预约不可用	预约不可用	预约不可用	预约不可用	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲
23:20-23:40	预约不可用	预约不可用	预约不可用	预约不可用	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲
23:40-23:59	预约不可用	预约不可用	预约不可用	预约不可用	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲	空闲

如在上机前发现时间上有问题，可以联系仪器管理员在【预约时间调整】模块进行时间的再次调整。

实验室共享仪器管理

首页 开放流程 预约管理 使用管理 维护管理 资源管理 预约与统计 绩效考核 基础信息 系统设置

预约管理

预约日期: 请输入开始时间 请输入结束时间 查询 高级搜索

每页 20 条记录 共 57 条记录

序号	预约日期	预约单号	预约日期	仪器编号	仪器名称	型号	仪器位置	存放地点	申请人姓名	申请人身份	联系电话	操作
1	2022-03-15	20220300018	2022-03-15	2015137500	实时荧光定量PCR	LC96	(1654)地楼	(20040403)达因楼403 (教师实验室2)	(20211785)朱地华	校内学生	1257226562	时间戳 查看
2	2022-03-15	20220300022	2022-03-14	2019276202	研究级单重荧光定量PCR	Nikon TSZR	(1654)地楼	(20040208)达因楼208 (研究生学习室)	(11654)地楼	校内教师	13987612105	时间戳 查看
3	2022-03-15	20220300023	2022-03-15	2015137500	实时荧光定量PCR	LC96	(1654)地楼	(20040403)达因楼403 (教师实验室2)	(20211785)朱地华	校内学生	13577236562	时间戳 查看
4	2022-03-14	20220300024	2022-03-14	2019276202	研究级单重荧光定量PCR	Nikon TSZR	(1654)地楼	(20040208)达因楼208 (研究生学习室)	(20210136)刘颖	校内学生	18722126983	时间戳 查看
5	2022-03-14	20220300025	2022-03-14	2015137500	实时荧光定量PCR	LC96	(1654)地楼	(20040403)达因楼403 (教师实验室2)	(20200136)尹博	校内学生	18208806460	时间戳 查看
6	2022-03-15	20220300026	2022-03-15	2020041202	超分辨率多功能成像系统	GE Amersham Imager 680	(1654)地楼	(20040208)达因楼208 (研究生学习室)	(20200155)徐亚	校内学生	18213591679	时间戳 查看
7	2022-03-15	20220300027	2022-03-15	2020041202	超分辨率多功能成像系统	GE Amersham Imager 680	(1654)地楼	(20040208)达因楼208 (研究生学习室)	(20200130)王乙	校内学生	17862928995	时间戳 查看
8	2022-03-15	20220300028	2022-03-15	2019276202	研究级单重荧光定量PCR	Nikon TSZR	(1654)地楼	(20040208)达因楼208 (研究生学习室)	(20210126)刘颖	校内学生	18722126983	时间戳 查看
9	2022-03-15	20220300029	2022-03-16	2019276202	研究级单重荧光定量PCR	Nikon TSZR	(1654)地楼	(20040208)达因楼208 (研究生学习室)	(20210136)刘颖	校内学生	18722126983	时间戳 查看
10	2022-03-16	20220300030	2022-03-16	2020041202	超分辨率多功能成像系统	GE Amersham Imager 680	(1654)地楼	(20040208)达因楼208 (研究生学习室)	(20190037)周志	校内学生	15750286038	时间戳 查看
11	2022-03-17	20220300031	2022-03-17	2015137500	实时荧光定量PCR	LC96	(1654)地楼	(20040403)达因楼403 (教师实验室2)	(20211785)朱地华	校内学生	13577236562	时间戳 查看
12	2022-03-17	20220300032	2022-03-17	2020041202	超分辨率多功能成像系统	GE Amersham Imager 680	(1654)地楼	(20040208)达因楼208 (研究生学习室)	(20200155)徐亚	校内学生	18213591679	时间戳 查看
13	2022-03-17	20220300033	2022-03-17	2020041202	超分辨率多功能成像系统	GE Amersham Imager 680	(1654)地楼	(20040208)达因楼208 (研究生学习室)	(20191206)张	校内学生	15182732673	时间戳 查看
14	2022-03-18	20220300034	2022-03-18	2015137500	实时荧光定量PCR	LC96	(1654)地楼	(20040403)达因楼403 (教师实验室2)	(20211785)朱地华	校内学生	13577236562	时间戳 查看
15	2022-03-18	20220300035	2022-03-18	2019276202	研究级单重荧光定量PCR	Nikon TSZR	(1654)地楼	(20040208)达因楼208 (研究生学习室)	(20211785)朱地华	校内学生	13577236562	时间戳 查看
16	2022-03-18	20220300036	2022-03-18	2019276202	研究级单重荧光定量PCR	Nikon TSZR	(1654)地楼	(20040208)达因楼208 (研究生学习室)	(20200136)尹博	校内学生	18208806460	时间戳 查看
17	2022-03-18	20220300037	2022-03-18	2019276202	研究级单重荧光定量PCR	Nikon TSZR	(1654)地楼	(20040208)达因楼208 (研究生学习室)	(20200136)尹博	校内学生	18208806460	时间戳 查看
18	2022-03-20	20220300038	2022-03-20	2019276202	研究级单重荧光定量PCR	Nikon TSZR	(1654)地楼	(20040208)达因楼208 (研究生学习室)	(20210136)刘颖	校内学生	18722126983	时间戳 查看
19	2022-03-22	20220300039	2022-03-21	2020041202	超分辨率多功能成像系统	GE Amersham Imager 680	(1654)地楼	(20040208)达因楼208 (研究生学习室)	(20200140)张	校内学生	15198771035	时间戳 查看
20	2022-03-22	20220300040	2022-03-22	2020041202	超分辨率多功能成像系统	GE Amersham Imager 680	(1654)地楼	(20040208)达因楼208 (研究生学习室)	(20191206)张	校内学生	15182732673	时间戳 查看

当前版本: v7.0.10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8. 成功后，学生可以使用学生卡或手机微信端扫码仪器，进行上机操作，仪器使用完成，学生刷卡下机，系统自动记录上下机时间。

9. 仪器管理员审核退回的申请单，申请人可在平台的【个人中心】-【我的预约单】模块进行修改并重新提交。尚未安排或者已经退回的预约单，预约人不想再次预约，也可选择退约，销毁预约单。

个人中心

我的预约单


修改 删除 提交 退约 评价

状态	预约单号	申请时间	预约单类型	仪器编号	仪器名称	所属单位
已安排	202203001353-1	2022-03-27(0...	机时预约	YQ2014002628	生物分析仪	陕西省环境工...
审核退回	202203000509-1	2022-03-15(0...	机时预约	001	测试仪器	陕西省环境工...
审核退回	202203000504-1	2022-03-14(0...	机时预约	001	测试仪器	陕西省环境工...
已安排	202203000503-1	2022-03-12(0...	机时预约	001	测试仪器	陕西省环境工...
已安排	202203000500-1	2022-03-17(0...	机时预约	YQ2014002628	生物分析仪	陕西省环境工...

首页 上一页 1 2 下一页 尾页

陕西省环境工程... 陕西省环境工程... 陕西省环境工程... 陕西省环境工程... 陕西省环境工程...


10. 使用完仪器后，如所使用仪器为缴费仪器，有费用产生，系统会自动计算费用，仪器管理员自己维护实际上机记录。根据所计算的费用进行缴费，由仪器管理员完成缴费确认。

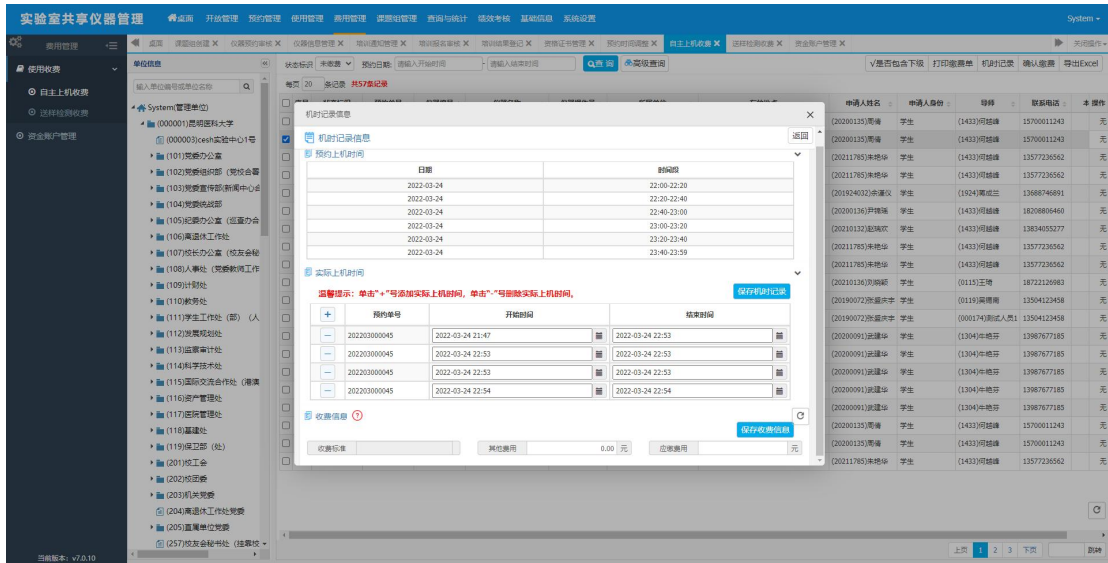


11. 仪器已经缴费完成后，仪器预约人可以在平台对仪器进行评价。评价后的内容在仪器详细信息中展示。



该仪器的仪器管理员可以在系统后台的【使用评价管理】中评价进行管理（可以修改这条评价是否在平台中展示）。

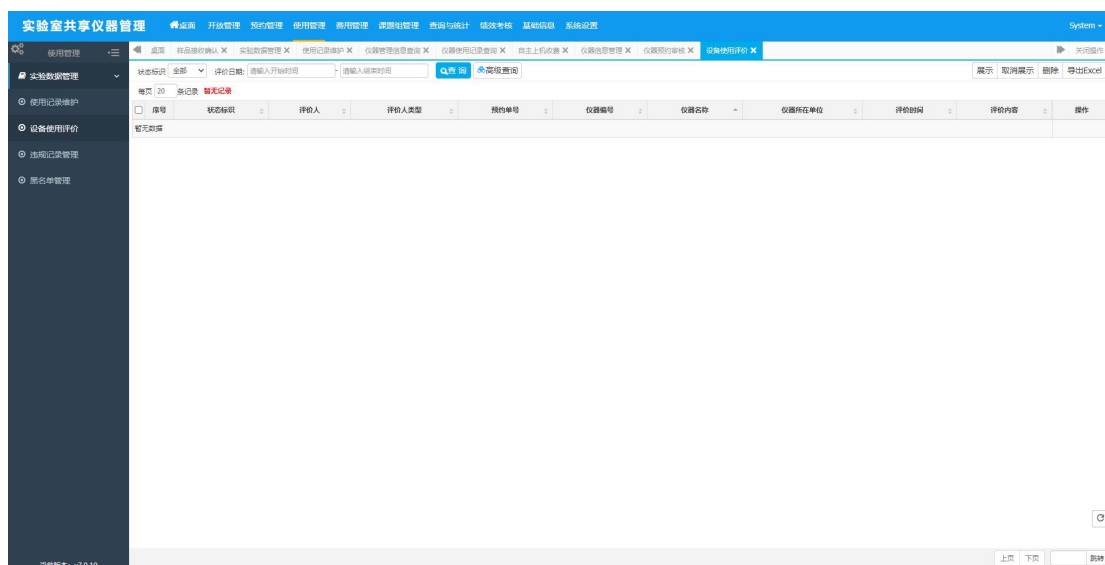

如果有违规使用，破坏仪器等行为，仪器管理员可以记录违规记录或者将使用人添加至黑名单，限制使用人使用仪器。

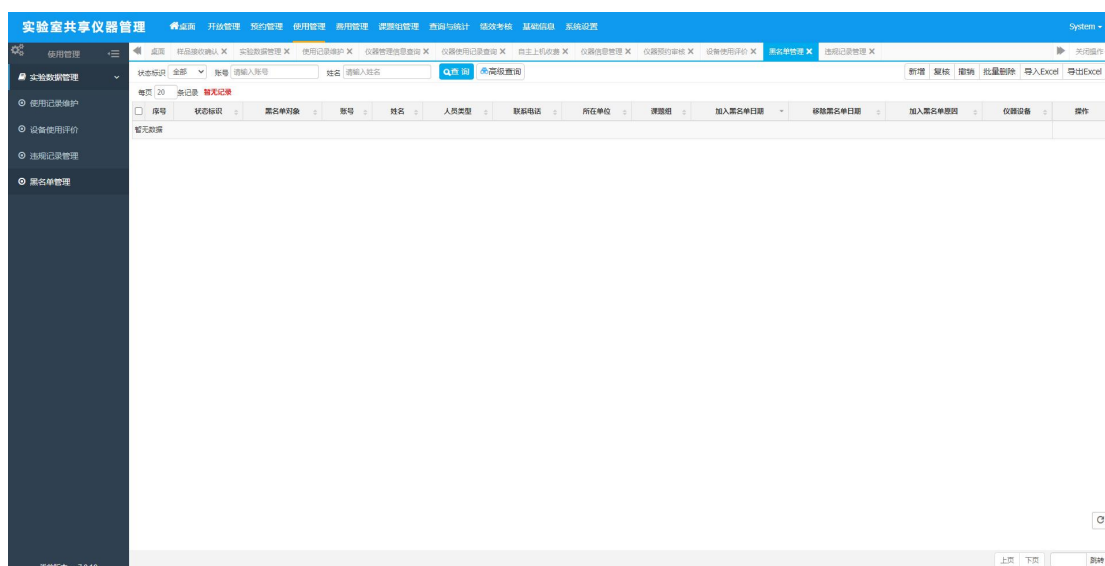

三. 手机端-机时预约：

12. 在微信【智慧昆医】公众号，点击【微服务】点击进入【仪器共享平台】或者【资产平台】-【实验室系统】即可跳转手机端。

13. 登录大型仪器预约设备共享平台：使用学生（学号）、教师（工号）、校外人员（先注册，由管理员在【校外人员审核】进行审核），密码登录平台。



实验室移动管理平台

教师 学生 公共账号

14. 进入【大型仪器】模块，点击【仪器预约】模块，进入仪器列表，点击仪器名称左边三角按钮展示仪器详细信息，选择预约，选择可选时段，点击下一步，填写相关预约单信息并提交，等待**仪器管理员**审核及安排实验时间。



添加常用

全部应用

全部

实验室管理

安全考试

安全检查

大型仪器



仪器预约



仪器收藏



培训申请



校外预约单



仪器查询



预约查询



仪器管理员审核



实验室预约



消息



工作台



我的



仪器预约列表

仪器分类 全部

仪器编号 请输入仪器编号

仪器名称 请输入仪器名称

▼ 仪器名称: 倒置显微镜 

仪器编号: 2001002636

▼ 仪器名称: 全自动生物化学分析仪 

仪器编号: 2002000817

▼ 仪器名称: 全自动血球计数仪 

仪器编号: 2002016324

▼ 仪器名称: 示教生物显微镜 

仪器编号: 2004002609

▼ 仪器名称: 倒置荧光显微摄影系统 


仪器编号: 2004002640

▼ 仪器名称: 荧光显微镜 

仪器编号: 2004002655

▼ 仪器名称: 原子荧光光度计 

仪器编号: 2005000748

▼ 仪器名称: 高压液相色谱仪 





仪器预约列表

仪器分类 全部
仪器编号 请输入仪器编号
仪器名称 请输入仪器名称

 仪器名称: 倒置显微镜
仪器编号: 2001002636



所在单位: (305)药学院

单价: 179104.48

规格: *

型号: LEICA DMIRB

存放地点: 科研楼4栋407 (不断电)

仪器设备功能:

仪器设备操作员: (1193)卿晨

状态: 正常运行

预约时间安排: 否

预约

送样

 仪器名称: 全自动生物化学分析仪





倒置显微镜仪器预约

可预约 ● 未开放/已过期 ● 他人已约 ● 我已约

	当前日期: 2022-03-31							
	上周							下周
时间段	周日 (2022-03-27)	周一 (2022-03-28)	周二 (2022-03-29)	周三 (2022-03-30)	周四 (2022-03-31)	周五 (2022-04-01)	周六 (2022-04-02)	
00:00-00:20								
00:20-00:40								
00:40-01:00								
01:00-01:20								
01:20-01:40								
01:40-02:00						已选择		
02:00-02:20								
02:20-02:40								
02:40-03:00								
03:00-03:20								

已选时间段 周五(2022-04-01) 01:40-02:00;

课题组:

下一步

返回

<倒置显微镜仪器预约

预约时段1:	周五(2022-04-01) 01:40-02:0	
共计:	0.33	小时
* 申请人:	(000000)System	
* 手机号:	<input type="text"/>	
* 导师:	请选择... ▼	
* 样品信息:	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>	
* 样品数量:	<input type="text"/>	
备 注:	<input style="width: 100%; height: 60px;" type="text"/>	

提交返回

15. 如果此仪器需要进行培训后方可使用，则点击“申请参加培训”按钮，点击报名按钮，填写并提交申请报名信息。

仪器预约列表

仪器分类	全部
仪器编号	请输入仪器编号
仪器名称	请输入仪器名称

▼ **仪器名称: 离子色谱仪**
 仪器编号: 20032568

▲ **仪器名称: 荧光定量系统**
 仪器编号: 20040340

所在单位: (001302)陕西省环境工程重点实验室

单价: 120016

规格: *

型号: *_BVS1

存放地点: 环境大楼413仪器室

仪器设备功能: 适合多种观察方法, 从明场到荧光, 可应用于样品中具有荧光特性和不具有荧光特性的微生物、微小颗粒观察、拍摄和录像

仪器设备操作人员: (010103310)曹书苗

状态: 正常运行

预约时间安排:

预约
申请参加培训
返回

▼ **仪器名称: 荧光分光光度计-FP-6500**
 仪器编号: 20042427

▼ **仪器名称: 超净工作台**
仪器预约申请
提交
返回

仪器管理员审核部分与平台申请审核一致, 在此不过多累述。